

Accreditation Criteria:
INSO/ISO15189:2025, 2nd. Revision
ISO15189:2022
Accreditation Certificate No.:
IACLD-ML12:00

Issue Date:01/07/2025
Scope Extension Date:03/28/2026
Renewal Date: 01/07/2027
Expiry Date: 01/07/2027
Scope of accreditation: in the
appendix



معیار اعتباربخشی :
استاندارد ملی ایران ایزو ۱۵۱۸۹
(تجدید نظر دوم ۱۴۰۳)
شماره گواهینامه اعتباربخشی :
IACLD-ML12:00

تاریخ صدور گواهینامه : ۱۴۰۳/۱۰/۱۸
تاریخ افزایش دامنه اعتبار: ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
تاریخ تجدید گواهینامه: ۱۴۰۵/۱۰/۱۸
تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه: ۱۴۰۵/۱۰/۱۸
دامنه شمول اعتباربخشی: مطابق پیوست

**Accreditation Body of Iranian
Association of Clinical Laboratory
Doctors (AB-IACLD)**

herewith confirms that :

نهاده اعتباربخشی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

تشخیصی طبی ایران (AB-IACLD)

بدین وسیله تأیید می نماید که :

**Medical Laboratory:
Kourosh Pathobiology Laboratory**

آزمایشگاه پزشکی :

آزمایشگاه پاتوبیولوژی کوروش

Address:

**NO.1, 3rd Floor, Amethyst Building, Banafshe
Allay, Eram Blvd., Mehrshahr, Karaj, Alborz, Iran
Tel: (+98)-026-34236400**

Fax :

E-mail/Website :

**Kourosh.lab96@gmail.com
WWW.Kouroshlab.com**


نشانی: ایران - البرز - کرج - مهرشهر - بلوار ارم - سه راه
شهرداری - کوچه بنفشه - ساختمان آمیتیس - طبقه سوم
- پلاک ۱
تلفن: ۰۲۶-۳۴۲۳۶۴۰۰
دورنگار :

پست الکترونیک / سایت اینترنتی :

**Kourosh.lab96@gmail.com
WWW.Kouroshlab.com**


**Has fulfilled the requirements for accreditation
within the scope in the appendix of this document .**

الزامات اعتباربخشی را در دامنه شمول تعیین شده در
پیوست این مدرک، برآورده نموده است.



IACLD

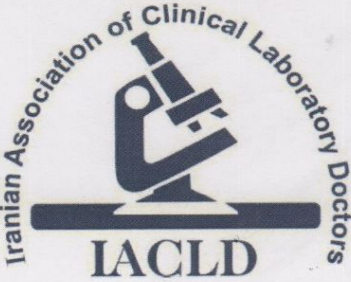

INSO/ISO15189:2025, 2 nd Revision ISO15189:2022 Accreditation Certificate No.: IACLD-ML12:00 Issue Date:01/07/2025 Scope Extension Date:03/28/2026 Renewal Date: 01/07/2027 Expiry Date: 01/07/2027 Scope of accreditation: in the appendix	 IACLD گواهینامه اعتباربخشی آزمایشگاه پزشکی Medical Laboratory Accreditation Certificate	معیار اعتباربخشی : استاندارد ملی ایران ایزو ۱۵۱۸۹ (تجدید نظر دوم ۱۴۰۳) شماره گواهینامه اعتباربخشی : IACLD-ML12:00 تاریخ صدور گواهینامه : ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ تاریخ افزایش دامنه اعتبار: ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ تاریخ تجدید گواهینامه: ۱۴۰۵/۱۰/۱۸ تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه: ۱۴۰۵/۱۰/۱۸ دامنه شمول اعتباربخشی: مطابق پیوست
---	---	---

Appendix- Scope of Accreditation:

Kourosh Pathobiology Laboratory

* A star mark indicates “Extended” items in the scope

پیوست - دامنه اعتباربخشی:

آزمایشگاه پاتوبیولوژی کوروش

*ردیف های ستاره دار نشان دهنده افزایش دامنه اعتبار است.

No	Discipline	Analyte/Test	Test sample	Test Method	Reference: National, International Standards/ In-house methods/ Equipment/
1	Bacteriology	Urine Culture	Urine	Culture Biochemical, Disk Diffusion	QA-WI-75 QA-CH-74 QA-WI-41
2	Bacteriology	Antimicrobial susceptibility testing	Urine	Culture Biochemical, Disk Diffusion	QA-WI-75 QA-CH-74 QA-WI-41
3	Clinical Chemistry	Glucose	Serum	Glucose oxidase/Peroxidase	Beckman/ Hitachi 912
4	Clinical Chemistry	HbA1C	Whole Blood	Enzymatic	Hitachi 912
5	Clinical Chemistry	ALP	Serum	End .P-Nitro phenyl phosphate(pNPP) point	Beckman/ Hitachi 912
6	Clinical Chemistry	ALT	Serum	IFCC NADH-Kinetic UV.	Beckman/ Hitachi 912



<https://ab.iaclid.com/> -Tel.: (+98 21) 88988649- 88970700-FAX: (+98 21) - 88970700

IACLD-F7:02

INSO/ISO15189:2025, 2nd. Revision ISO15189:2022 Accreditation Certificate No.: IACLD-ML12:00 Issue Date:01/07/2025 Scope Extension Date:03/28/2026 Renewal Date: 01/07/2027 Expiry Date: 01/07/2027 Scope of accreditation: in the appendix	 گواهینامه اعتباربخشی آزمایشگاه پزشکی Medical Laboratory Accreditation Certificate	معیار اعتباربخشی: استاندارد ملی ایران ایزو ۱۵۱۸۹ (تجدید نظر دوم ۱۴۰۳) شماره گواهینامه اعتباربخشی: IACLD-ML12:00 تاریخ صدور گواهینامه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ تاریخ افزایش دامنه اعتبار: ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ تاریخ تجدید گواهینامه: ۱۴۰۵/۱۰/۱۸ تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه: ۱۴۰۵/۱۰/۱۸ دامنه شمول اعتباربخشی: مطابق پیوست
--	--	---

Appendix- Scope of Accreditation:

Kourosh Pathobiology Laboratory


* A star mark indicates “**Extended**” items in the scope

پیوست- دامنه اعتباربخشی:

آزمایشگاه پاتوبیولوژی کوروش


*ردیف های ستاره دار نشان دهنده افزایش دامنه اعتبار است.

No	Discipline	Analyte/Test	Test sample	Test Method	Reference: National, International Standards/ In-house methods/ Equipment/
7	Clinical Chemistry	AST	Serum	FCC NADH-Kinetic UV. I	Beckman/ Hitachi 912
8	Clinical Chemistry	Total Calcium	Serum	Arsenazo III	Beckman/ Hitachi 912
9	Clinical Chemistry	HDL-C	Serum	Direct Enzymatic	Beckman/ Hitachi 912
10	Clinical Chemistry	Triglycerides	Serum	Lipase / Peroxidase (Colorimetry)	Beckman/ Hitachi 912
11	Clinical Chemistry	Phosphorus	Serum	Ammonium molybdate /Colorimetric	Beckman/ Hitachi 912
12	Clinical Chemistry	Total Bilirubin	Serum	Dichloroanilin (DCA)	Beckman/ Hitachi 912



<https://ab.iaclcd.com/> -Tel: (+98 21) 88988649- 88970700-FAX: (+98 21) - 88970700

IACLD-F7:02

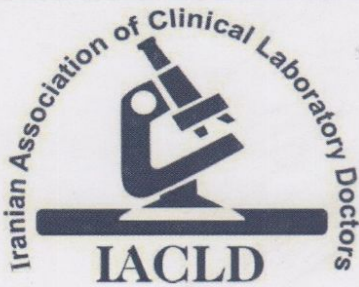INSO/ISO15189:2025, 2nd. Revision ISO15189:2022 Accreditation Certificate No.: IACLD-ML12:00 Issue Date:01/07/2025 Scope Extension Date:03/28/2026 Renewal Date: 01/07/2027 Expiry Date: 01/07/2027 Scope of accreditation: in the appendix	 گواهینامه اعتباربخشی آزمایشگاه پزشکی Medical Laboratory Accreditation Certificate	معیار اعتباربخشی: استاندارد ملی ایران ایزو ۱۵۱۸۹ (تجدید نظر دوم ۱۴۰۳) شماره گواهینامه اعتباربخشی: IACLD-ML12:00 تاریخ صدور گواهینامه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ تاریخ افزایش دامنه اعتبار: ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ تاریخ تجدید گواهینامه: ۱۴۰۵/۱۰/۱۸ تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه: ۱۴۰۵/۱۰/۱۸ دامنه شمول اعتباربخشی: مطابق پیوست
---	--	---

Appendix- Scope of Accreditation:

Kourosh Pathobiology Laboratory


* A star mark indicates “**Extended**” items in the scope

پیوست - دامنه اعتباربخشی:

آزمایشگاه پاتوبیولوژی کوروش


*ردیف های ستاره دار نشان دهنده افزایش دامنه اعتبار است.

No	Discipline	Analyte/Test	Test sample	Test Method	Reference: National, International Standards/ In-house methods/ Equipment/
13	Clinical Chemistry	UREA	Serum	Urease / Berthelot/Colorimetric	Beckman/ Hitachi 912
14	Clinical Chemistry	URIC ACID	Serum	Uricase /Peroxidase	Beckman/Hitachi 912
15	* Clinical Chemistry	K	Serum	Ion-Selective Electrode (ISE)	Easylyte/AUDICAM
16	* Clinical Chemistry	Na	Serum	Ion-Selective Electrode (ISE)	Easylyte/ AUDICAM
17	* Clinical Chemistry	Creatinine	Serum	jaffe	Beckman/Hitachi 912
18	* Clinical Chemistry	Choloesterol	Serum	CHOD-POD	Beckman/Hitachi 912



<https://ab.iacld.com/> -Tel.: (+98 21) 88988649- 88970700-FAX: (+98 21) - 88970700

IACLD-F7:02

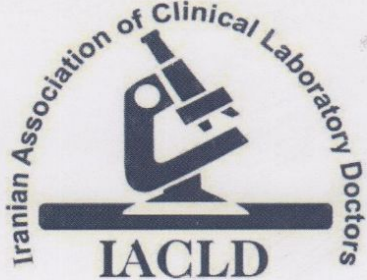INSO/ISO15189:2025, 2nd. Revision ISO15189:2022 Accreditation Certificate No.: IACLD-ML12:00 Issue Date:01/07/2025 Scope Extension Date:03/28/2026 Renewal Date: 01/07/2027 Expiry Date: 01/07/2027 Scope of accreditation: in the appendix	 گواهینامه اعتباربخشی آزمایشگاه پزشکی Medical Laboratory Accreditation Certificate	معیار اعتباربخشی: استاندارد ملی ایران ایزو ۱۵۱۸۹ (تجدید نظر دوم ۱۴۰۳) شماره گواهینامه اعتباربخشی: IACLD-ML12:00 تاریخ صدور گواهینامه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ تاریخ افزایش دامنه اعتبار: ۱۴۰۵/۱۰/۱۸ تاریخ تجدید گواهینامه: ۱۴۰۵/۱۰/۱۸ تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه: ۱۴۰۵/۱۰/۱۸ دامنه شمول اعتباربخشی: مطابق پیوست
---	---	---

Appendix- Scope of Accreditation:

Kourosh Pathobiology Laboratory


* A star mark indicates “**Extended**” items in the scope

پیوست - دامنه اعتباربخشی:

آزمایشگاه پاتوبیولوژی کوروش


*ردیف های ستاره دار نشان دهنده افزایش دامنه اعتبار است.

No	Discipline	Analyte/Test	Test sample	Test Method	Reference: National, International Standards/ In-house methods/ Equipment/
19	* Clinical Chemistry	LDL-C	Serum	Direct-Enzymatic	Beckman/Hitachi 912
20	* Clinical Chemistry	Direct Bilirubin	Serum	Dichloroanilin (DCA)	Beckman/Hitachi 912
21	* Clinical Chemistry	CPK	Serum	Kinetic UV-NAC	Beckman/Hitachi 912
22	* Clinical Chemistry	LDH	Serum	DGKC	Beckman/Hitachi 912
23	* Clinical Chemistry	AMYLASE	Serum	CN PG3-Kinetic	Beckman/Hitachi 912
24	* Clinical Chemistry	ALB	Serum	BROMOCRESOL GREEN	Beckman/Hitachi 912



<https://ab.iacld.com/> -Tel.: (+98 21) 88988649- 88970700-FAX: (+98 21) - 88970700

IACLD-F7:02

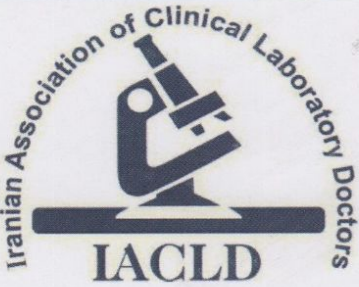INSO/ISO15189:2025, 2nd. Revision ISO15189:2022 Accreditation Certificate No.: IACLD-ML12:00 Issue Date:01/07/2025 Scope Extension Date:03/28/2026 Renewal Date: 01/07/2027 Expiry Date: 01/07/2027 Scope of accreditation: in the appendix	 گواهینامه اعتباربخشی آزمایشگاه پزشکی Medical Laboratory Accreditation Certificate	معیار اعتباربخشی : استاندارد ملی ایران ایزو ۱۵۱۸۹ (تجدید نظر دوم ۱۴۰۳) شماره گواهینامه اعتباربخشی : IACLD-ML12:00 تاریخ صدور گواهینامه : ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ تاریخ افزایش دامنه اعتبار: ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ تاریخ تجدید گواهینامه: ۱۴۰۵/۱۰/۱۸ تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه: ۱۴۰۵/۱۰/۱۸ دامنه شمول اعتباربخشی: مطابق پیوست
--	---	---

Appendix- Scope of Accreditation:

Kourosh Pathobiology Laboratory


* A star mark indicates “**Extended**” items in the scope

پیوست- دامنه اعتباربخشی:

آزمایشگاه پاتوبیولوژی کوروش


*ردیف های ستاره دار نشان دهنده افزایش دامنه اعتبار است.

No	Discipline	Analyte/Test	Test sample	Test Method	Reference: National, International Standards/ In-house methods/ Equipment/
25	* Clinical Chemistry	Fe (Iron)	Serum	FERROZINE	Beckman/Hitachi 912
26	* Hematology	WBC	Whole Blood	Flow Cytometry	Sysmex XN-330/orphee
27	* Hematology	RBC	Whole Blood	Electrical Impedance	Sysmex XN-330/orphee
28	* Hematology	Hb	Whole Blood	Flow Cytometry	Sysmex XN-330/orphee
29	* Hematology	HCT	Whole Blood	Calculated	Sysmex XN-330/orphee
30	* Hematology	MCV	Whole Blood	Electrical Impedance	Sysmex XN-330/orphee



<https://ab.iacld.com/> -Tel.: (+98 21) 88988649- 88970700-FAX: (+98 21) - 88970700

IACLD-F7:02

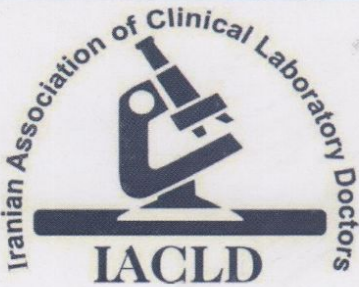INSO/ISO15189:2025, 2nd. Revision ISO15189:2022 Accreditation Certificate No.: IACLD-ML12:00 Issue Date:01/07/2025 Scope Extension Date:03/28/2026 Renewal Date: 01/07/2027 Expiry Date: 01/07/2027 Scope of accreditation: in the appendix	 گواهینامه اعتباربخشی آزمایشگاه پزشکی Medical Laboratory Accreditation Certificate	معیار اعتباربخشی: استاندارد ملی ایران ایزو ۱۵۱۸۹ (تجدید نظر دوم ۱۴۰۳) شماره گواهینامه اعتباربخشی: IACLD-ML12:00 تاریخ صدور گواهینامه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ تاریخ افزایش دامنه اعتبار: ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ تاریخ تجدید گواهینامه: ۱۴۰۵/۱۰/۱۸ تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه: ۱۴۰۵/۱۰/۱۸ دامنه شمول اعتباربخشی: مطابق پیوست
--	---	---

Appendix- Scope of Accreditation:

Kourosh Pathobiology Laboratory

* A star mark indicates “**Extended**” items in the scope

پیوست- دامنه اعتباربخشی:

آزمایشگاه پاتوبیولوژی کوروش

*رذیف های ستاره دار نشان دهنده افزایش دامنه اعتبار است.

No	Discipline	Analyte/Test	Test sample	Test Method	Reference: National, International Standards/ In-house methods/ Equipment/
31	* Hematology	MCH	Whole Blood	Calculated	Sysmex XN-330/orphee
32	* Hematology	MCHC	Whole Blood	Calculated	Sysmex XN-330/orphee
33	* Hematology	Platelets	Whole Blood	Electrical Impedance	Sysmex XN-330/orphee
34	* Hematology	Complete blood cell count (CBC) with Differential	Whole Blood	Flow Cytometry And check by the manual microscope method	Sysmex XN-330/orphee



<https://ab.iacld.com/> -Tel.: (+98 21) 88988649- 88970700-FAX: (+98 21) - 88970700

IACLD-F7:02